

鸡卵黄 2 (VTG2) 酶联免疫分析

试剂盒使用说明书

本试剂盒仅供研究使用。

检测范围：96T

3 μ g/L -100 μ g/L

使用目的：

本试剂盒用于测定鸡血清、血浆及相关液体样本中卵黄 2 (VTG2) 含量。

实验原理

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡卵黄 2 (VTG2) 。用纯化的鸡卵黄 2 (VTG2) 抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入卵黄原 2 (VTG2)，再与 HRP 标记的卵黄 2 (VTG2) 抗体，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的卵黄 2 (VTG2) 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度 (OD 值)，通过标准曲线计算样品中鸡卵黄 (2 VTG2) 浓度。

试剂盒组成

| | | | | | |
|---|--------|------------------|----|---------------------|-------------------|
| 1 | 30倍浓 | 20ml \times 1瓶 | 7 | 终止液 | 6ml \times 1瓶 |
| 2 | 酶标试剂 | 6ml \times 1瓶 | 8 | 标准品 (200 μ g/L) | 0.5ml \times 1瓶 |
| 3 | 酶标包被板 | 12孔 \times 8条 | 9 | 标准品稀释液 | 1.5ml \times 1瓶 |
| 4 | 样品稀释液 | 6ml \times 1瓶 | 10 | 说明书 | 1份 |
| 5 | 显色剂 A液 | 6ml \times 1瓶 | 11 | 封板膜 | 2张 |
| 6 | 显色剂 B液 | 6ml \times 1/瓶 | 12 | 密封袋 | 1个 |

标本要

1. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20 $^{\circ}$ C 保存，但应避免反复冻融
2. 不能检测含NaN₃的样品，因 NaN₃抑制辣根过 (HRP) 活性。

操作步骤

1. 标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。


| | | |
|----------------|-------|--|
| 100 μ g/L | 5号标准品 | 150 μ l 的原倍标准品加入 150 μ l 标准品稀释液 |
| 50 μ g/L | 4号标准品 | 150 μ l 的 5号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液 |
| 25 μ g/L | 3号标准品 | 150 μ l 的 4号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液 |
| 12.5 μ g/L | 2号标准品 | 150 μ l 的 3号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液 |
| 6.25 μ g/L | 1号标准品 | 150 μ l 的 2号标准品加入 150 μ l 标准品稀释液 |

2. 加样：分别设空白孔 (空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同)、标准孔、

待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50 μ l，待测样品孔中先加样品稀释液 40 μ l，然后再加待测样品 10 μ l（样品最终稀释度为 5 倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

3. 温育：用封板膜封板后 37 $^{\circ}$ C 温育 30 分钟。
4. 配液：将 30 倍浓 30 倍稀释后备用
5. 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静 30 秒后弃去，如此重复 5 次，拍干。
6. 加酶：每孔加入酶标试剂 50 μ l，空白孔除外。
7. 温育：操作同 3。
8. 洗涤：操作同 5。
9. 显色：每孔先加入显色剂 A 50 μ l，再加入显色剂 B 50 μ l，轻轻震荡混匀，37 $^{\circ}$ C 避光显色 10 分钟。
10. 终止：每孔加终止液 50 μ l，终止反应（此时蓝色立转黄色）。
11. 测定：以空白空调零，450nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 分钟以内进行。

操作程序总：

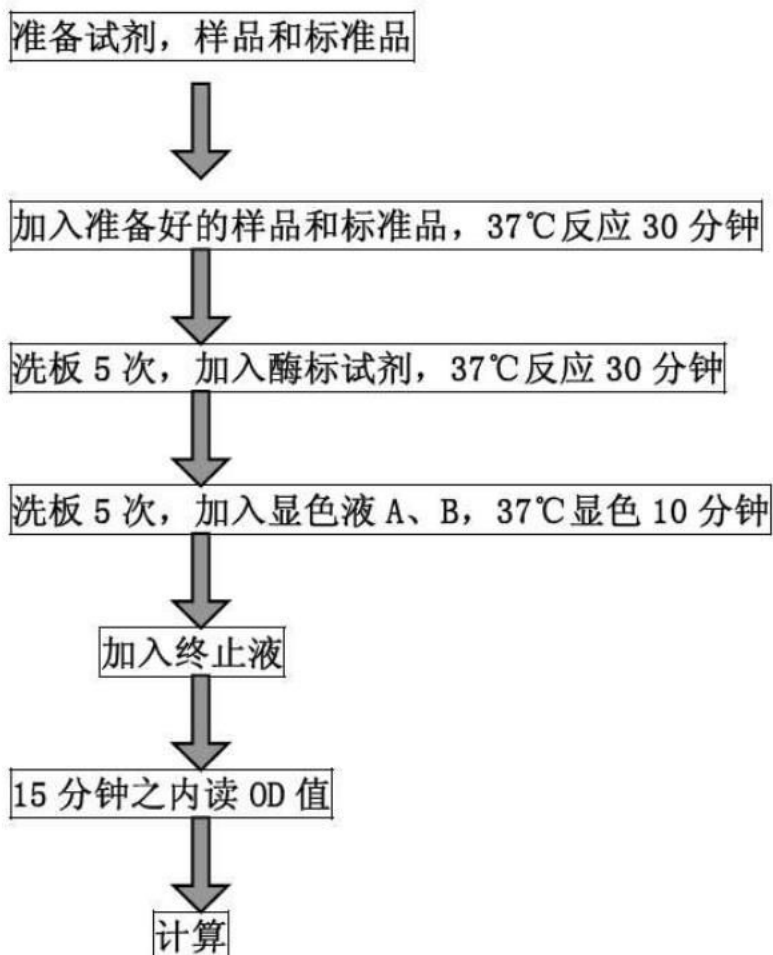

计算

以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与 OD 值计算出标

准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

注意事项

1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。
2. 浓洗涤液可能会有 析出，稀释时可在浴中加温助溶，洗涤时不影响 。
3. 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在 5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本 OD值大于标准品孔第一孔的 OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（ $\times n \times 5$ ）。
5. 封板膜只限一次性使用，以避免交叉 。
6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行，试验 。
8. 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。

保存条件及有效期

1. 试剂盒保存：2-8℃。
2. 有效期：6个月